


Meditrade Display 2015

M 1:1

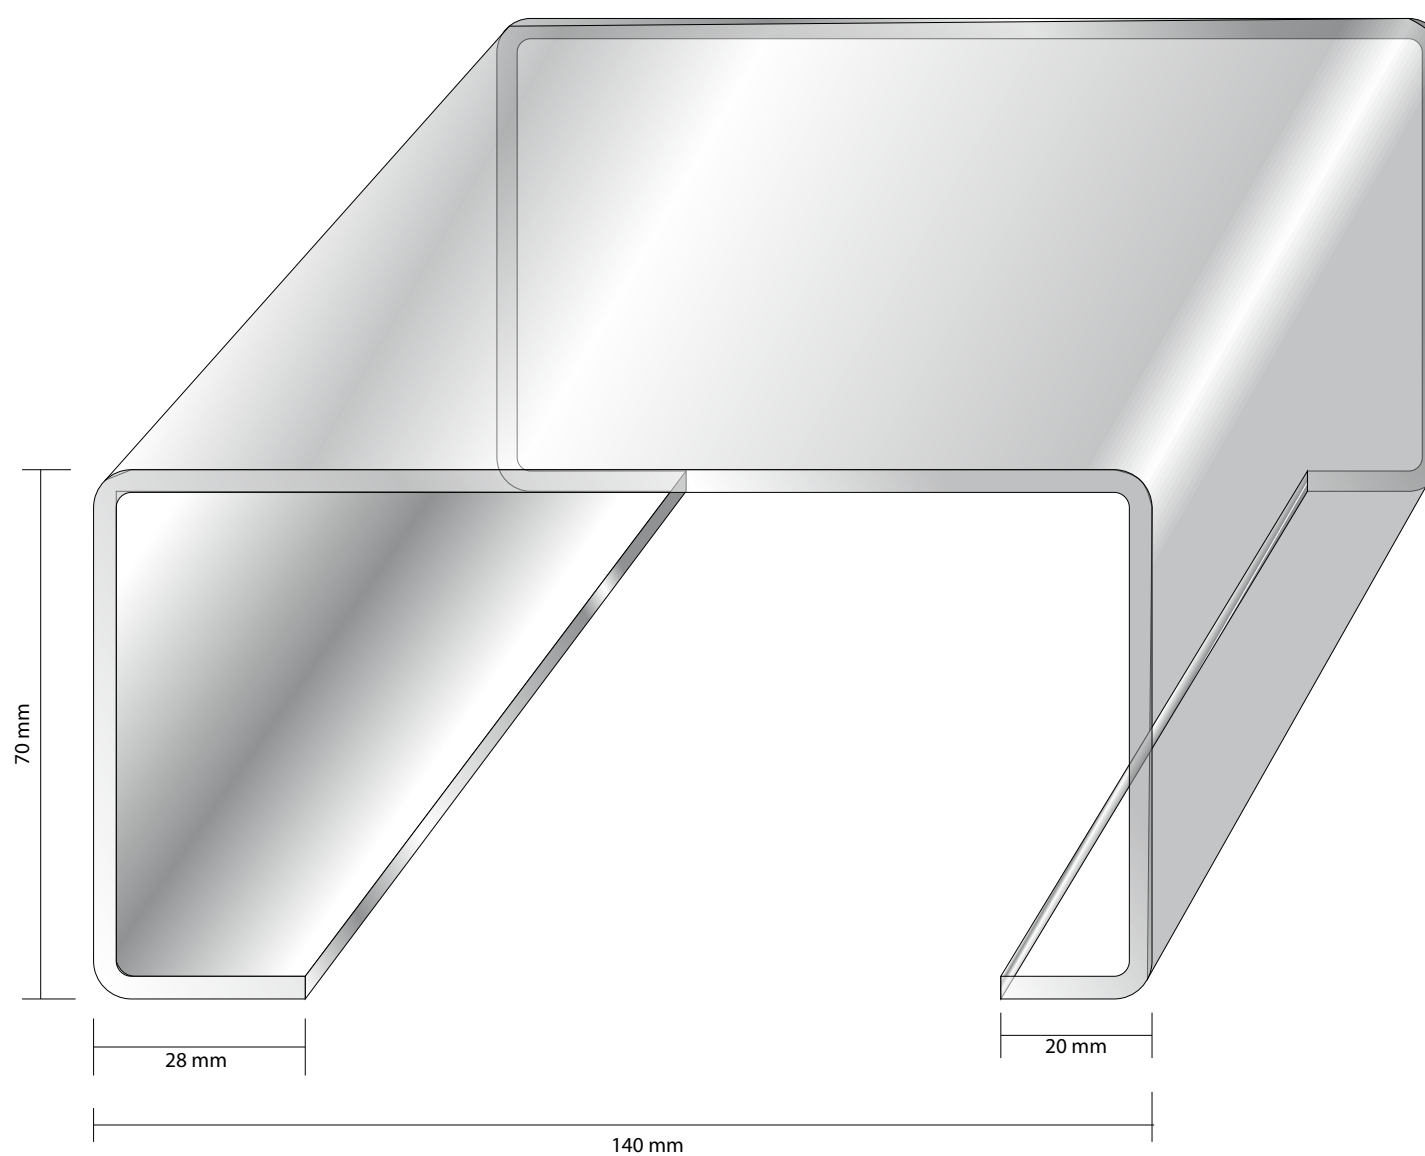

Korrekturabzug

Dieser Korrekturabzug dient zur Überprüfung der Richtigkeit des Textes und der Farb- bzw. Logoanordnung. Wir bitten um genaue Prüfung, Fehlerkorrektur und schnellstmögliche Druckfreigabe durch Rücksendung per Fax mit Stempel und Unterschrift. Für nicht beseitigte Fehler können wir keine Verantwortung übernehmen. Die Farben werden bestmöglich an die Farbangaben angeglichen, dennoch kann es zu Farbabweichungen kommen.

Bemerkung:

Datum:

Unterschrift/Stempel:

Senkung nach hinten



Wandhalterung Ghost

